

Многофункциональный влажной очистки и дезинфекции станция

“PEREKSA”

(KF specifikācija TU (32.50.50-007-49003903-2020)

CE Nr.4-04-2021-00

Руководство по эксплуатации

Произведено В Европейском Союзе

Содержание

Введение.....	3
Предупреждающие знаки на Оборудовании.....	3
I. Назначение. Область применения.....	3
II. Устройство и принцип действия.....	4
III. Технические характеристики	7
IV. Использование по назначению	8
V. Порядок работы	10
VI. Комплектность.....	14
VII. Ремонт.....	15
VIII. Хранение	15
IX. Транспортирование	15
X. Гарантии Изготовителя.....	16
XI. Сведения об утилизации.....	17

Введение

Настоящее Руководство предназначено для персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию многофункциональной станции для влажной уборки и дезинфекции «PEREKSA» по (KF specifikācija TU (32.50.50-007-49003903-2020) (далее – станция «PEREKSA»).

Перед первым применением оборудования необходимо ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности, действовать в соответствии с ними.

Необходимо сохранить Руководство для дальнейшего пользования.

Станция «PEREKSA» является оборудованием общего назначения. Не подлежит регистрации в качестве медицинского изделия.

Предупреждающие знаки на Оборудовании

На Оборудование нанесен следующий предупреждающий знак:

	Осторожно! Опасное электрическое напряжение! После подключения к источнику питания оборудование находится под опасным для жизни напряжением. Доступ к находящимся под напряжением узлам и блокам разрешается только уполномоченному и квалифицированному персоналу. Перед проведением работ по санитарной обработке, техническому обслуживанию и ремонту оборудование должно быть отключено от электросети.
	Пар, слабая струя Опасность ожога, не подносить руки под струю пара и не направлять струю пара на людей и других живых существ.


I. Назначение. Область применения.

- 1.1. Станция "PEREKSA" предназначена для проведения влажной текущей, генеральной, профилактической уборки с одновременной дезинфекцией или без нее в организациях, выполняющих влажную уборку и/или дезинфекцию поверхностей, текстильных материалов для собственных нужд и/или в качестве услуги (в том числе на промышленных предприятиях, в детских, общеобразовательных, культурно-оздоровительных, гостиничных организациях, организациях, оказывающих транспортные услуги, в медицинских организациях, для обработки санитарных автомобилей и пр.) С помощью станции «PEREKSA» возможна обработка всех видов поверхностей помещений, оборудования, мебели, иных моющихся по-

верхностей (таких как линолеум, кафель, керамическая плитка, окрашенные поверхности, металлические и пластиковые поверхности, тканые и синтетические материалы), и текстильных изделий, выдерживающих кратковременное воздействие температуры до 100° С

II. Устройство и принцип действия

- 2.1. Станция "PEREKSA" включает корпус (1), блок управления и сигнализации (2), систему нагрева воды и подачи пара, рабочую рукоятку подачи пара (3), систему дозирования дезинфицирующего средства, насадку универсальную (4), насадку малую.

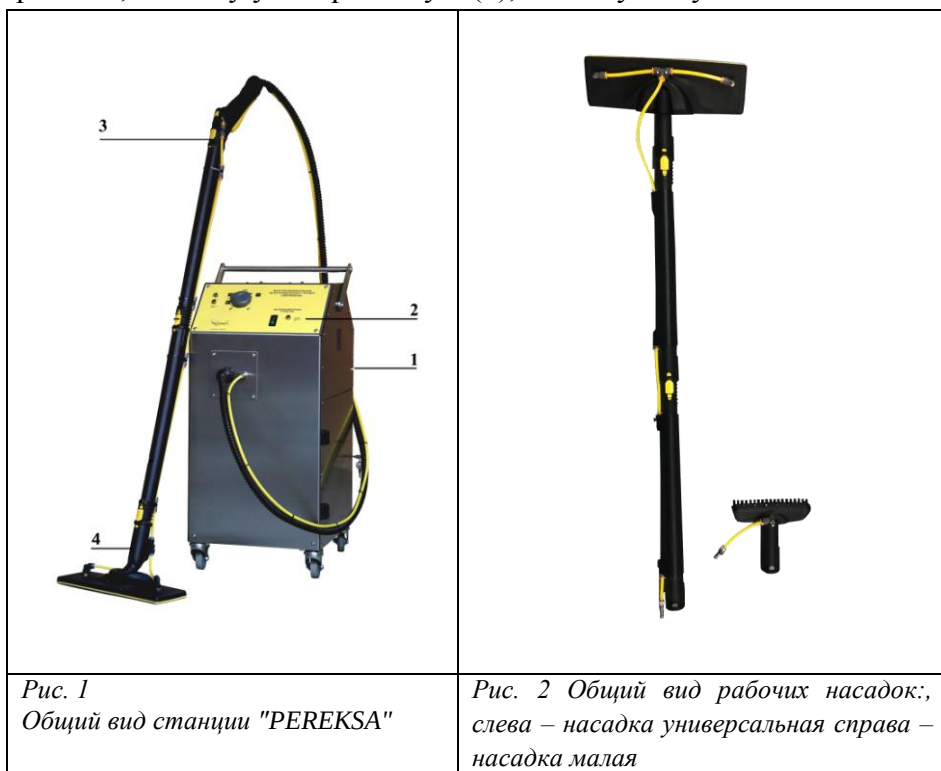

- 2.2. Корпус оснащен колесами, обеспечивающими мобильность станции "PEREKSA".
- 2.3. Система дозирования дезинфицирующего средства включает резервуар для дезинфицирующего средства, оснащенный датчиком минимального уровня жидкости, насос-дозатор, питающую трубку жёлтого цвета, соединенную с выходным(-и) отверстием(-ями) насадки.

- 2.4. Система нагрева воды и подачи пара включает резервуар для воды, оснащенный датчиком минимального уровня воды, питающий посредством водяного насоса котёл, оснащенный предохранительным клапаном, термодатчиком. Подача пара к насадке осуществляется по армированному герметичному шлангу.
- 2.5. Панель блока управления и сигнализации оснащена переключателем режимов работы, индикатором нагрева воды в котле, индикатором низкого уровня воды в резервуаре, кнопкой включения подачи дезинфицирующего средства, индикатором низкого уровня дезинфицирующего средства в резервуаре.
- 2.6. Универсальная насадка оснащена липучками для крепления текстильных насадок. Малая насадка так же используется совместно с текстильной насадкой. Текстильные насадки могут иметь ярлык цветового кодирования для удобства идентификации Пользователем назначения текстильной насадки в зависимости от объекта обработки/зоны обработки.
- 2.7. Системы дозирования дезинфицирующего средства и подачи водяного пара изолированы друг от друга, смешение двух сред происходит только в зоне рассеивания насадки, что обеспечивает равномерное распределение мелкодисперсионных капель дезинфицирующего средства в паре, без потери его дезинфицирующих свойств.
- 2.8. Эффективность процессов уборки и дезинфекции основана на комбинированном воздействии водяного пара под давлением и перекиси водорода 6%. Одновременно достигается моющий, дезодорирующий эффект и дезинфицирующее действие (антимикробное, бактерицидное (включая микобактерий туберкулеза, шигелл, кишечной палочки, золотистого стафилококка, спорообразующих бактерий), противогрибковое (в том числе в отношении *Candida albicans*, *Aspergillus*, *Penicillium*), вирулицидное (в том числе в отношении вируса полиомиелита, аденовируса).
- 2.9. Станция «PEREKSA» может применяться без дезинфицирующего средства для ежедневных влажных уборок и очистки стойких загрязнений; обработка паром без дезинфицирующего средства так же обеспечивает снижение общей микробной контаминации поверхностей и дезодорирующий эффект.

- 2.10. При поставке универсальная насадка прикреплена к рабочей рукоятке подачи пара.
- 2.11. Малая насадка так же крепится непосредственно к рабочей рукоятке подачи пара.
- 2.12. Для замены универсальной насадки на малую нужно сделать следующие действия:
 1. Убедиться, что станция «PEREKSA» выключена, а остатки конденсата и пара в системе стравлены (см. п. 5.23.2)
 2. Разъединить питающую трубку желтого цвета. Для этого оттянуть пружинный фиксатор (б) на розетке (а) в сторону рукоятки. Если при этом штекер (в) сам не отсоединился, вынуть его из розетки.

Внимание, не пытайтесь выдернуть трубку из быстроразъемного соединителя (1)!

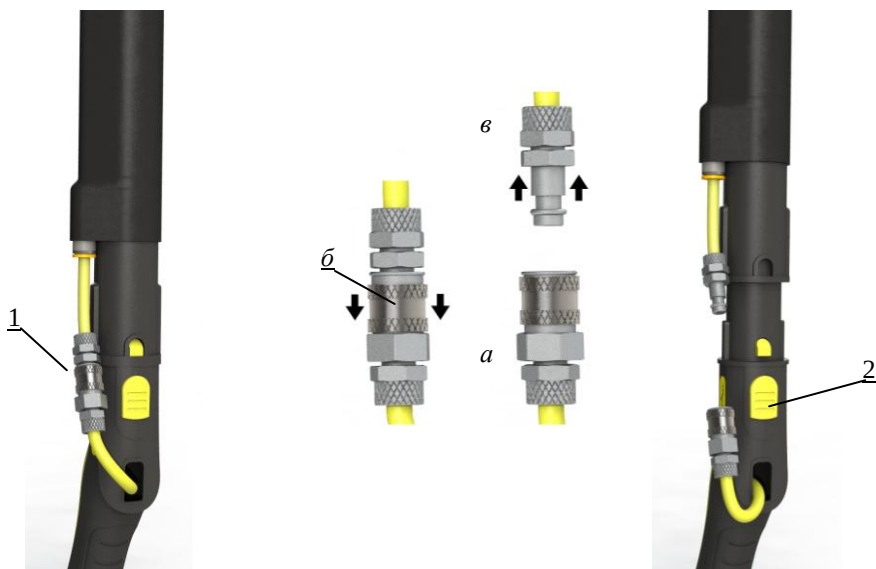


Рис. 3 Процесс разъединения питающей трубки желтого цвета:

1 – быстроразъемный соединитель;

а – розетка, б – пружинный фиксатор, в – штекер

2 – фиксатор насадки.

3. Отсоединить универсальную насадку от рабочей рукоятки подачи пара, нажав фиксатор насадки (2).
4. Вставить в рабочую рукоятку подачи пара малую насадку до срабатывания фиксатора (2).
5. Соединить питающую трубку желтого цвета, вставив штекер (в) в розетку (а) до срабатывания пружинного фиксатора (б).

III. Технические характеристики

3.1. Основные технические и функциональные характеристики Оборудования представлены в Таблице 1:

Таблица 1. Основные технические и функциональные характеристики.

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры корпуса с выдвинутой рукояткой выдвижной (в рабочем состоянии), не более мм - глубина - ширина - высота	700 500 1400
2	Габаритные размеры корпуса со сложенной рукояткой выдвижной, не более мм - глубина - ширина - высота	700 500 800
2	Тип оборудования	Передвижное
3	Объем резервуара для дезинфектанта, л	Не более 5
4	Объем резервуара для воды, л	Не более 5
5	Объем котла, л	Не более 0,5
6	Рабочее давление пара в котле, барр, не более	4,2
7	Температура обработки, не более	105°C
8	Расход перекиси водорода 6%	(750±100) мл
9	Время непрерывной работы при максимально допустимом заполнении резервуара водой на режиме 3	Не менее 2 ч
10	Электропитание, В, Гц	220В±10% 50 Гц
11	Потребляемая мощность, не более, Вт	3000
12	Масса нетто не более, кг	30

3.2. Рекомендованное время непрерывной работы – не более 8 часов в сутки.

3.3. Корректированный уровень звуковой мощности – не более 60 дБа.

3.4. Средний срок службы до списания – 4 года.

IV. Использование по назначению

4.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1.1. К работе со станцией "PEREKSA" допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктажи по охране труда, пожаро- и электробезопасности, обучение, инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи, изучившие настоящее Руководство по эксплуатации и инструкцию по применению на дезинфицирующее средство.
- 4.1.2. При эксплуатации станции "PEREKSA" должны соблюдаться правила техники безопасности при работе с электрическими изделиями, а также следующие меры безопасности:
- Оператор должен быть обеспечен стандартной одеждой для уборки, комбинезоном (при необходимости), защитными очками или защитной маской для лица, средствами защиты органов дыхания, перчатками или из неопрена или резиновыми, обеспечивающими защиту от аэрозольных загрязнений.
 - Работа в режиме дезинфекции должна осуществляться в помещениях при обеспечении достаточной вентиляции. После обработки помещение проветривают в течение 10-30 минут в зависимости от площади помещения и времени обработки. Во время обработки помещение так же рекомендуется проветривать.
 - Допускается работа в режиме дезинфекции совместно с паром только с использованием совместимых дезинфицирующих средств, содержащих перекись водорода 6%. Совместимое дезинфицирующее средство может дополнительно содержать только стабилизаторы/консерванты перекиси водорода. Совместимое дезинфицирующее средство не должно содержать дополнительных активных веществ и компонентов, кроме перекиси водорода (в том числе обладающих дезинфицирующей или моющей активностью).
 - Работа в режиме обработки только паром не требует проветривания помещений, возможно длительное использование оборудования в присутствии других людей (пациентов, посетителей и т.д.).

- При наличии аллергических заболеваний внимательно следите за своим состоянием при первом использовании оборудования на режиме дезинфекции; завершите работу при выявлении повышенной чувствительности.
- Не прикасайтесь руками к соплу выхода пара включенного оборудования.
- Не направляйте струю пара в сторону человека, животного, штепсельной вилки или на само устройство.
- Всегда выключайте станцию "PEREKSA", когда она остается без присмотра.
- Не используйте станцию "PEREKSA", если поврежден кабель питания или иные узлы или элементы.
- Не прикасайтесь к станции "PEREKSA" мокрыми руками или ногами.
- Не работайте со станцией "PEREKSA", если заливные отверстия не закрыты специальными крышками.
- Не тяните за кабель питания или за само оборудование, чтобы вынуть штепсельную вилку из розетки.
- Не допускайте попадания на станцию "PEREKSA" влаги во время ее работы.
- Не допускайте замерзания воды в резервуарах и трубах.
- При необходимости используйте совместимые с оборудованием удлинители (кабель с сечением 2,5 мм² и более);
- Соблюдайте дополнительные меры безопасности, указанные в инструкции на дезинфицирующее средство.

4.2. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:

- 4.2.1. При попадании паров на кожу немедленно промыть участок кожи холодной проточной водой.
- 4.2.2. При попадании пара в глаза немедленно (!) промыть их прохладной проточной водой в течение 15 минут, при необходимости обратиться к окулисту.
- 4.2.3. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) следует выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение.
- 4.2.4. Рот и носоглотку прополоскать водой и выпить теплое питье (молоко или минеральную воду). При необходимости обратиться к врачу.

- 4.2.5. При воздействии непосредственно перекиси водорода 6% оказывать меры первой помощи в соответствии с указаниями инструкции на дезинфицирующее средство.
- 4.3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ станции "PEREKSA"
- 4.3.1. Распаковать станцию "PEREKSA" от транспортной тары, освободить от защитной наружной упаковки.
- 4.3.2. После хранения Оборудования в холодном помещении или после транспортировки в зимних условиях необходимо выдержать его не менее 2 часов при комнатной температуре.
- 4.3.3. Проверить отсутствие повреждений узлов и элементов станции "PEREKSA".
- 4.3.4. Установить рукоятку корпуса в рабочее положение, зафиксировать ее винтами посредством шестигранного ключа.
- 4.3.5. При необходимости поменять рабочую насадку убедиться, что переключатель рабочих режимов переведен в положение "ВЫКЛ", подача дезинфицирующего средства отключена и станция "PEREKSA" находится в выключенном состоянии, далее руководствоваться п. 2.11.
- 4.3.6. Условия окружающей среды при эксплуатации станции "PEREKSA": внутри и вне помещений, в защищенном от дождя, снега и ветра месте при температуре окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности до 100%.

V. Порядок работы

- 5.1. Перед началом работы убедиться в целостности всех узлов, в наличии комплектующих, вспомогательных материалов, средств индивидуальной защиты, технологической и эксплуатационной документации.
- 5.2. Все операции при эксплуатации станции "PEREKSA" необходимо выполнять в средствах индивидуальной защиты: в одежде для уборки, комбинезоне (при необходимости), защитных очках, перчатках из неопрена или резиновых, защитной маске или респираторе, обеспечивающей защиту от воздействия аэрозолей.
- 5.3. Наполнить резервуар через заливное отверстие с маркировкой "ВОДА" водой, с маркировкой "ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА" – дезинфицирующим средством (перекисью водорода 6%) (при необходимости). После наполнения резервуара каждое заливное отверстие закрывают пробкой.
- Примечание:
Теплая вода сокращает время нагрева.
- 5.4. Подключить Оборудование к сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц в розетку с заземлением.

- 5.5. Повернуть переключатель режимов работы, расположенный на панели управления, в положение "БКЛ" (предварительный прогрев) для включения станции "PEREKSA". Зеленый индикатор нагрева воды начнет мигать. Если планируется использовать функцию дезинфекции, при первом запуске или после длительного перерыва в эксплуатации включить подачу перекиси водорода 6%, нажав переключатель подачи дезинфицирующего средства в позицию «БКЛ».
- 5.6. Когда индикатор нагрева воды начнет гореть постоянно, станция «PEREKSA» готова к обработке паром. Когда дезинфицирующее средство начнет выходить из рабочей насадки, станция «PEREKSA» готова к обработке дезинфицирующим средством. Временно отключить подачу дезинфицирующего средства для проведения операций по п. 5.7-5.9.
- 5.7. Выбрать необходимую интенсивность подачи пара посредством переключателя режимов работы, расположенного на панели управления:
- 1 – минимальный режим подачи пара;
 - 2 – средний режим подачи пара;
 - 3 – максимальный режим подачи пара;
 - 4 – режим подачи пересыщенного пара.
- 5.8. Режим дезинфекции используют на режимах 1, 2 или 3.
- 5.9. Нажать на рукоятке рычаг подачи пара – пар начнет выходить. В начале смены или после длительного перерыва в использовании (более 15 минут) пропустить в течение 15 секунд пар через систему подачи пара для ее прогрева. При этом из рабочей насадки может выходить конденсат, который целесообразно собрать в емкость. Выключить подачу пара.
- 5.10. Надевание новой текстильной насадки или её замена должна производиться при выключенной подаче пара и при выключенной подаче дезинфицирующего средства.
- 5.11. При использовании режима дезинфекции с текстильной насадкой универсальной, надеть ее, включить подачу дезинфицирующего средства и ожидать, пока текстильная насадка пропитается дезинфицирующим средством (порядка 1-1,5 минуты). После этого включить подачу пара на нужном режиме, упереть рабочую насадку в пол, подождать (порядка 15 секунд), пока текстильная насадка прогреется паром, после этого осуществлять обработку поверхностей/объектов. Манипуляции по п. 5.11 повторять при каждой смене текстильной насадки универсальной.

- 5.12. При использовании режима дезинфекции с текстильной насадкой малой, надеть её, сразу включить подачу дезинфицирующего средства и подачу пара на нужном режиме и осуществлять обработку поверхностей/объектов.
- 5.13. Для изменения интенсивности выхода пара отпустить рычаг подачи пара на рукоятке, переключателем режимов работы выбрать нужный режим. Для очищения сильных загрязнений может понадобиться воздействие пара большей интенсивности.
- 5.14. Для выключения режима дезинфекции установить на панели управления переключатель подачи дезинфицирующего средства в положение «ВЫКЛ».
- 5.15. Для обеспечения бактерицидного и спороцидного действия могут быть использованы режимы обработки паром «1», «2», «3» совместно с дезинфицирующим средством.
- 5.16. Для обеспечения фунгицидного действия используется режим «3» совместно с дезинфицирующим средством.
- 5.17. Для обеспечения вирулицидной активности в отношении наиболее устойчивых безоболочечных вирусов действия обработку поверхностей осуществляют дважды на режиме "3" с применением дезинфицирующего средства, окрашенные масляной краской стены обрабатывают трижды.
- 5.18. Обработка в иных режимах так же приводит к существенному снижению микробной контаминации поверхностей.
- 5.19. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Перед обработкой рекомендуется очистить поверхность от сильных загрязнений (например, подмести пол).

Обработать поверхности паром или паром с применением дезинфицирующего средства. Для обеспечения дезинфицирующего эффекта проводите обработку паром совместно с дезинфицирующим средством на скорости около 10 сантиметров в секунду.

Рекомендуется обрабатывать поверхности сверху вниз, от более чистых к более грязным, по направлению к выходу из помещения.

Разделение текстильных насадок в зависимости от категории/зоны помещения, вида обрабатываемого объекта регламентируется внутренними стандартами организации.

При необходимости, проверьте устойчивость поверхности к обработке на небольшом участке поверхности. Склеенные углы и края под воздействием пара могут отклеиться; поверхности, покрытые краской, не допускающей мытьё, как правило, неустойчивы к обработке паром.

Запрещается обработка поверхностей из цветных металлов.

При обработке термолабильных поверхностей можно использовать быструю обработку через двойной слой текстильной насадки или очистить поверхность текстильной насадкой, увлажнённым паром без прямой обработки поверхности паром.

При обработке стеклянных поверхностей необходимо предварительно прогреть всю поверхность, быстро пройдя по ней, перед основной обработкой.

По завершении обработки проветрите помещение.

5.20. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для дезинфекции текстильных материалов расправить их на горизонтальной поверхности, использовать для обработки рабочую насадку малую в режиме в соответствии с п. 5.14-5.16. Не допускать наличие складок на обрабатываемом участке.

5.21. ОСВЕЖЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Станция "PEREKSA" может использоваться для освежения одежды и разглаживания мелких складок. Допустимо осуществлять обработку текстильных материалов в вертикальном (подвешенном состоянии).

5.22. ДОЛИВАНИЕ ВОДЫ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

5.22.1. О низком уровне воды или дезинфицирующего средства сигнализируют соответствующие световые и звуковые индикаторы на панели управления.

5.22.2. Отключить Оборудование от сети (перевести переключатель режимов работы в положение «ВЫКЛ») и наполнить резервуар через соответствующее заливное отверстие.

5.23. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

5.23.1. Установить регулятор интенсивности пара в положение «ВЫКЛ». Отсоединить станцию "PEREKSA" от сети.

5.23.2. Нажимать рычаг подачи пара, пока не прекратится выход пара.

5.24. ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

5.24.1. Снять все использованные текстильные насадки и отправить на дезинфекцию и/или стирку в соответствии с п. 5.25.2-5.25.4.

5.25. Дезинфекционная обработка оборудования

5.25.1. Отключить оборудование от сети, обработать его поверхности кислородсодержащим дезинфицирующим средством методом протирания.

- 5.25.2. Использованные текстильные насадки дезинфицировать (если это требуется в соответствии с порядком организации работ или если текстильная насадка используется для дезинфекции) дезинфицирующим средством, пригодным для текстильных материалов, разрешенным к применению. Для дезинфекции текстильных насадок запрещается использовать хлорсодержащие дезинфицирующие средства.
- 5.25.3. Перед стиркой текстильные насадки предварительно прополоскать в целях удаления песка и прочих крупных частиц, способных повредить структуру волокна при стирке. Стирать при температуре не более 60° С, отжим не выше 800 об/мин. При стирке рекомендуется использовать специальные моющие средства, не содержащие щелочей и хлора. Воздействие щелочи, соединений хлора приводит к ускорению потери текстильной насадкой функциональных свойств. Запрещено использовать отбеливатели, кондиционеры, ополаскиватели.
- 5.25.4. После стирки провести естественную сушку текстильных насадок в проветриваемом помещении. Допустимо использовать специализированное сушильное оборудование без теплового воздействия, осуществляющего сушку изделия за счет конвекции воздушного потока.

VI. Комплектность

В комплектность поставки станции "PEREKSA" входят:

Наименование	Количество, шт.
Многофункциональная станция для влажной уборки и дезинфекции «PEREKSA»	1
Насадка малая	1 шт.
Текстильная насадка универсальная	не менее 4 шт.
Текстильная насадка малая	не менее 1 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Эксплуатационная документация:	
Руководство по эксплуатации	1 шт.

VII. Ремонт

- 7.1. Решение о необходимости проведение ремонта станции "PEREKSA" принимается организацией, осуществляющей ремонт, совместно с Владелец (Пользователем) по результатам технического диагностирования.
- 7.2. Ремонт может выполняться как на месте эксплуатации, так и на производственных площадях организации, осуществляющей ремонт, в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки оборудования.

VIII. Хранение

Упакованное Оборудование следует хранить в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 85%.

Дезинфицирующее средство (перекись водорода 6%) хранят в соответствии с инструкцией по применению.

IX. Транспортирование

- 9.1. Транспортирование станции "PEREKSA" производится всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, утверждёнными в установленном порядке.
- 9.2. Условия транспортирования Оборудования **до ввода в эксплуатацию** в части воздействия климатических факторов:
 - температура от минус 50°C до плюс 50°C;
 - относительная влажность до 100% при температуре 25°C.
- 9.3. Оборудование, подвергавшееся транспортированию при отрицательных температурах, должно быть выдержано в транспортной упаковке при комнатной температуре не менее 12 часов.
- 9.4. Оборудование, подвергавшееся ранее эксплуатации, не допускается транспортировать при отрицательных температурах.
- 9.5. Сведения о транспортировании дезинфицирующего средства "Перекись водорода 6%" - в соответствии с инструкцией по применению.

Х. Гарантии Изготовителя

- 10.1. Производитель гарантирует исправную работу оборудования и полное соответствие рабочих параметров заявленным характеристикам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации.**
- 10.2. В течение гарантийного срока Производитель выполняет гарантийный ремонт и замену вышедших из строя частей и узлов оборудования за счет собственных средств в случае, если обнаруженные неисправности, возникли по его вине.
- 10.3. Производитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств в следующих случаях:
- Если оборудование использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения условий по подключению, правил, условий и требований к эксплуатации оборудования, а также иных требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации или иных соответствующих документах законодательства;
 - В случае самостоятельной переделки или замены элементов, узлов оборудования, либо разборки оборудования без предварительного разрешения и согласования с Производителем;
 - Если оборудование имеет следы самостоятельного ремонта;
 - Если оборудование или его узлы имеют внешние механические повреждения, возникшие после передачи оборудования Покупателю;
 - Если оборудование или его узлы имеют повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей;
 - Если отсутствует оформленный в установленном порядке Гарантийный талон.
 - Если работы по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию или ремонту проводились организациями, не имеющими аккредитации Производителя, и/или лицами без соответствующей квалификации.

XI. Сведения об утилизации

- 11.1. При изготовлении Оборудования используются материалы, которые не являются опасными для окружающей среды и человека.
- 11.2. Оборудование не подлежит утилизации совместно с бытовым мусором. Утилизация производится в соответствии с общими требованиями к утилизации электрического оборудования.
- 11.3. Комплектующие, не содержащие электрические компоненты, могут быть удалены совместно с бытовым.
- 11.4. Сведения об утилизации дезинфицирующего средства "Перекись водорода 6%" – в инструкции по применению.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Многофункциональная станция для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA", заводской номер № _____
упакован SIA "Dezmag" (KF specifikācija TU (32.50.50-007-49003903-2020) согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Многофункциональная станция для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA », заводской номер № _____
изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией () и признан годным к эксплуатации.

Уполномоченное лицо

должность

личная подпись

расшифровка
подписи

год, месяц, число

М.П.

SIA "Dezmag"
Latvia, Daugavpils, Rīgas iela 34-1A, LV -5401
(KF specifikācija TU (32.50.50-007-49003903-2020))

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Многофункциональная станция для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA", заводской номер № _____

Дата изготовления: "___" _____ 20__ г.

Штамп предприятия:

Информация о продаже:

Название, адрес, телефон торговой организации:

Дата продажи: "___" _____ 20__ г.

Подпись и фамилия продавца: _____

(М.П.)



Приложение 1.

Результаты определения бактерицидной активности многофункциональной станции для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA"

Метод протирания, экспозиция – минимальный (1), средний (2), максимальный (3) режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства								
Определяемые показатели	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования	Результаты исследования				
				линолеум	пластик	керамическая плитка	металл	окрашенная поверхность
E. Coli 1275 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%	«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» Р 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
St. aureus 906 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Ps. aeruginosa (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Bacillus cereus (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Mycobacterium B₅ (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Candida albicans (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Salm. enter. (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Sh. sonnei (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

Приложение 2.

Результаты определения бактерицидной активности multifunctional станции для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA"

Метод протирания, экспозиция – средний режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства								
Определяемые показатели	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования	Результаты исследования				
				линолеум	пластик	керамическая плитка	металл	окрашенная поверхность
E. Coli 1275 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%	«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» Р 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
St. aureus 906 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Ps. aeruginosa (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Bacillus cereus (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Mycobacterium B₅ (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Candida albicans (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Salm. enter. (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Sh. sonnei (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

Приложение 3.

Результаты определения бактерицидной активности многофункциональной станции для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA"

Метод протирания, экспозиция – максимальный режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства								
Определяемые показатели	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования	Результаты исследования				
				линолеум	пластик	керамическая плитка	металл	окрашенная поверхность
E. Coli 1275 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%	«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности» Р 4.2.2643-10	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
St. aureus 906 (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Ps. aeruginosa (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Bacillus cereus (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Mycobacterium B₅ (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Candida albicans (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Salm. enter. (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Sh. sonnei (2 млрд. КОЕ/мл)	Не менее 99,99	%		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99

Приложение 4.

Результаты определения эффективности многофункциональной станции для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA" для инактивации безоболочечных вирусов человека на различных поверхностях

Метод протирания, экспозиция – минимальный/максимальный режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства				
Материал	Эффективность по аденовирусу, %		Эффективность по вирусу Коксаки В3, %	
	Минимальный	Максимальный	Минимальный	Максимальный
Стекло	99,97	100,00	99,99	100,00
Пластик	99,90	99,99	99,94	100,00
Окрашенная стена	99,68	99,97	99,82	99,98
Металл	99,90	100,00	99,99	100,00
Кафель	99,98	100,00	99,94377	100,00

Приложение 5.

Результаты определения фунгицидной эффективности многофункциональной станции для влажной уборки и дезинфекции "ПЕРЕКСА"

Метод протирания, экспозиция – минимальный/максимальный режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства				
Материал	Эффективность по Aspergillus niger шт. РКПГ F 1249/80-2, %		Эффективность по Penicillium chrysogenum шт. РКПГ F 1350, %	
	Минимальный	Максимальный	Минимальный	Максимальный
Линолеум	97,07	>99,99	99,99	>99,99
Пластик	98,30	>99,99	99,94	>99,99
Окрашенная стена	99,87	>99,99	99,50	>99,50
Металл	>99,99	>99,99	99,56	>99,99
Кафель	99,91	>99,99	99,52	>99,99

Приложение 6.

Оценка совместимости поверхностей с обработкой многофункциональной станцией для влажной уборки и дезинфекции "PEREKSA"

Вид поверхности	Метод воздействия	Визуальная оценка изменения внешнего вида поверхности		
		минимальный режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства	средний режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства	максимальный режим подачи пара с подачей дезинфицирующего средства
пластик	метод протирания	без изменений	без изменений	без изменений
керамическая плитка	метод протирания	без изменений	без изменений	без изменений
окрашенные поверхности	метод протирания	без изменений	без изменений	без изменений
металл	метод протирания	без изменений	без изменений	без изменений
линолеум	метод протирания	без изменений	без изменений	без изменений

